Cirugía con Menos Trauma

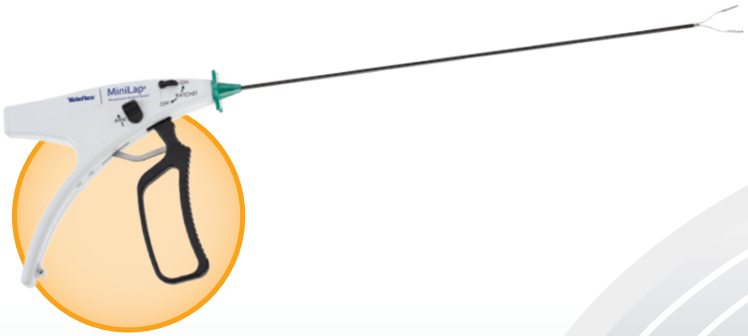

MiniLap® System
Con mango MiniGrip®

Volumen del defecto calculado **12 veces menor** al de un trocar promedio de 5 mm*

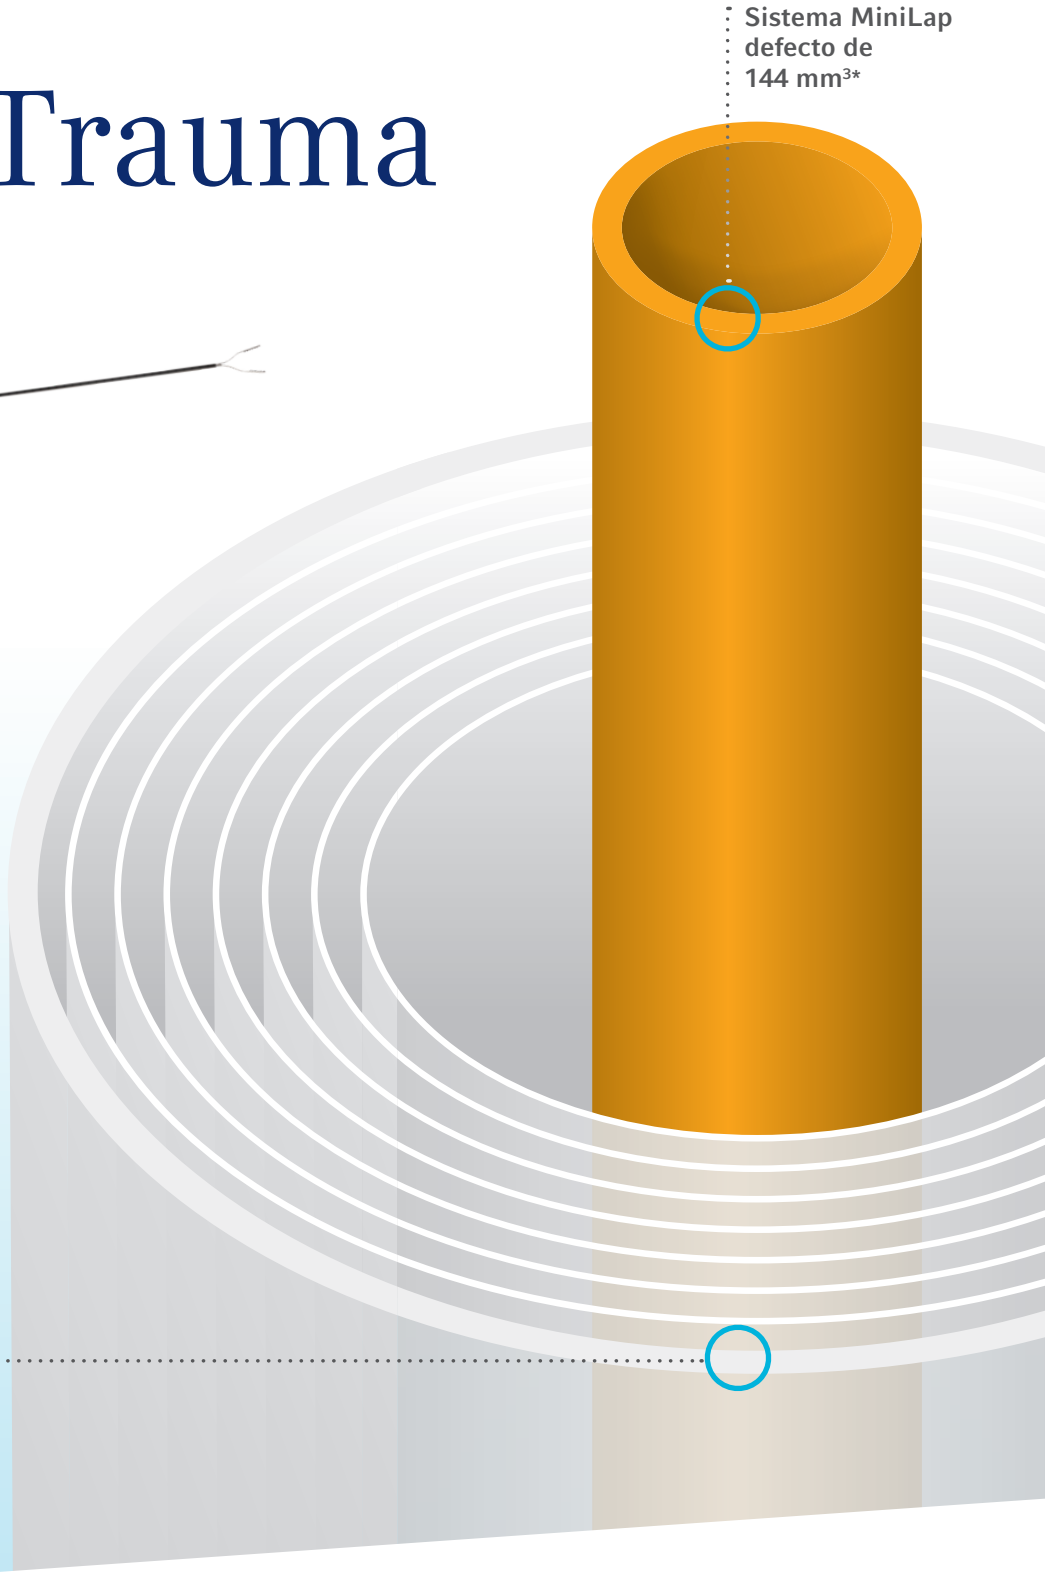

*Teleflex Incorporated. Trocar Defect Volume Study (TRQ-00003429). 2016. Los resultados del banco de prueba pueden no ser indicativos del desempeño clínico. Defect volumes calculated based on cylindrical volume of $\pi r^2 h$ and abdominal wall height of 31.85 mm (de Carvalho GL, Cavazzola LT. Can mathematic formulas help us with our patients? Surg Endosc. 2011; 25: 336-337.).

Teleflex, el logotipo de Teleflex , MiniGrip y MiniLap son marcas comerciales o marcas registradas de Teleflex Incorporated o sus afiliadas en los EE. UU. o en otros países. Las demás marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. La información incluida en el presente documento no sustituye las instrucciones de uso del producto.
Los productos incluidos en el presente documento pueden no estar disponibles en todos los países. Comuníquese con su representante local. Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso.
© 2020 Teleflex Incorporated. Todos los derechos reservados. MC-006284 LA ES

Teleflex®

Teleflex· 3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville, NC 27560
Para obtener información sobre productos comuníquese con la.cs@teleflex.com o +1.919.433.4999
teleflex.com